


# **IDK<sup>®</sup> DAO ELISA**

***Zur in-vitro-Bestimmung von Diaminoxidase (DAO)  
in Serum***

***For the in vitro determination of DAO in serum***

Gültig ab / Valid from 2018-03-22

**REF K 8500**



**IVD**



**Immundiagnostik AG**, Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany

Tel.: +49 6251 70190-0

Fax: + 49 6251 849430

e.mail: [info@immundiagnostik.com](mailto:info@immundiagnostik.com) [www.immundiagnostik.com](http://www.immundiagnostik.com)



# Inhalt

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. VERWENDUNGSZWECK</b>                          | <b>2</b>  |
| <b>2. EINLEITUNG</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>3. INHALT DER TESTPACKUNG</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>4. ERFORDERLICHE LABORGERÄTE UND HILFSMITTEL</b> | <b>3</b>  |
| <b>5. LAGERUNG UND VORBEREITUNG DER REAGENZIEN</b>  | <b>4</b>  |
| <b>6. PROBENLAGERUNG UND -VORBEREITUNG</b>          | <b>5</b>  |
| <i>Probenlagerung und -stabilität</i>               | 5         |
| <i>Probenvorbereitung</i>                           | 5         |
| <b>7. TESTDURCHFÜHRUNG</b>                          | <b>5</b>  |
| <i>Testprinzip</i>                                  | 5         |
| <i>Pipettierschema</i>                              | 5         |
| <b>8. ERGEBNISSE</b>                                | <b>7</b>  |
| <b>9. EINSCHRÄNKUNGEN</b>                           | <b>8</b>  |
| <b>10. QUALITÄTSKONTROLLE</b>                       | <b>8</b>  |
| <i>Referenzbereiche</i>                             | 8         |
| <i>Heparinbehandlung</i>                            | 9         |
| <b>11. TESTCHARAKTERISTIKA</b>                      | <b>11</b> |
| <i>Präzision und Reproduzierbarkeit</i>             | 11        |
| <i>Wiederfindung in der Verdünnung</i>              | 11        |
| <i>Analytische Sensitivität</i>                     | 12        |
| <b>12. VORSICHTSMASSNAHMEN</b>                      | <b>12</b> |
| <b>13. TECHNISCHE MERKMALE</b>                      | <b>12</b> |
| <b>14. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TEST</b>             | <b>13</b> |
| <b>15. LITERATUR</b>                                | <b>13</b> |

## 1. VERWENDUNGSZWECK

Der hier beschriebene Assay ist für die Bestimmung von Diaminoxidase (DAO) in Serum geeignet. Nur zur *in-vitro*-Diagnostik.

## 2. EINLEITUNG

Die Diaminoxidase (DAO) ist das entscheidende körpereigene Abbauenzym für Histamin. Obwohl DAO praktisch im gesamten Körper vorkommt, ist der Darm ihr wichtigster Wirkungsort. Die enzymatische Aktivität der DAO bestimmt die Abbaugeschwindigkeit des Histamins. Liegt ein DAO-Mangel bzw. eine -Hemmung vor, kann der Organismus mit der Nahrung aufgenommenes oder aus körpereigenen Zellen freigesetztes Histamin nicht rasch genug abbauen und es treten die Symptome einer Histamin-Intoleranz auf. Millionen von Menschen leiden nach dem Genuss bestimmter Nahrungsmittel unter Beschwerden wie Magen-Darm-Problemen, Migräne, Reizungen der Nasenschleimhaut, sowie anderen allergieähnlichen Symptomen. Zuviel Histamin im Körper kann für dieses umfangreiche Beschwerdebild verantwortlich sein.

Eine Bestimmung der DAO-Konzentration in Serum (K 8500) zusammen mit einer Bestimmung der DAO-Aktivität (K 8220 DAO REA) stellt einen geeigneten Marker für die Differentialdiagnostik der Histamin-Intoleranz und damit assoziierter Krankheitsbilder dar.

Unser IDK® DAO-ELISA bestimmt die Konzentration der Diaminoxidase in Serum.

### Indikationen

- Häufige Kopfschmerzen oder Migräne
- Schnupfen nach dem Genuss histaminhaltiger Nahrungsmittel
- Gewebeödeme
- Schwellung der Augenlider
- Hautrötungen
- Gliederschmerzen
- Magen-Darm-Beschwerden
- Überwachung einer histaminfreien Diät

## 3. INHALT DER TESTPACKUNG

| Art. Nr. | Bezeichnung | Kit-Komponenten                 | Menge               |
|----------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| K 8500   | PLATE       | Mikrotitermodul, vorbeschichtet | 12 x 8 Vertiefungen |

| Art. Nr. | Bezeichnung | Kit-Komponenten                                                           | Menge       |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| K 8500   | WASHBUF     | Waschpufferkonzentrat, 5 x                                                | 4 x 100 ml  |
| K 8500   | STD         | Standards, lyophilisiert<br>(Konzentrationen der Spezifikation entnehmen) | 4 x 5 vials |
| K 8500   | CTRL1       | Kontrolle, lyophilisiert<br>(Bereich der Spezifikation entnehmen)         | 4 x 1 vial  |
| K 8500   | CTRL2       | Kontrolle, lyophilisiert<br>(Bereich der Spezifikation entnehmen)         | 4 x 1 vial  |
| K 8500   | AB          | Detektionsantikörperkonzentrat,<br>biotinyliert                           | 1 x 200 µl  |
| K 8500   | CONJ        | Konjugatkonzentrat,<br>peroxidase markiert (Streptavidin)                 | 1 x 200 µl  |
| K 8500   | ABBUF       | Verdünnungspuffer für AB und CONJ,<br>gebrauchsfertig                     | 1 x 50 ml   |
| K 8500   | SAMPLEBUF   | Probenverdünnungspuffer,<br>gebrauchsfertig                               | 1 x 50 ml   |
| K 8500   | SUB         | Substrat (Tetramethylbenzidin), ge-<br>brauchsfertig                      | 1 x 15 ml   |
| K 8500   | STOP        | Stopplösung, gebrauchsfertig                                              | 1 x 15 ml   |

Für Nachbestellungen von Einzelkomponenten verwenden Sie als Bestellnummer die Artikelnummer gefolgt von der Bezeichnung.

#### 4. ERFORDERLICHE LABORGERÄTE UND HILFSMITTEL

- Laborübliche Reaktionsgefäße aus Polypropylen (1,5 ml)
- Laborübliches Reaktionsgefäß (15 ml)
- Folie zum Abkleben der Mikrotiterplatte
- Vortex-Mixer
- Reinstwasser\*
- Thermoschüttler für Mikrotiterplatten für 37 °C (z.B. Modell Shake ID2 erhältlich bei Immundiagnostik AG)
- Mikrotiterplattenphotometer (benötigte Filter siehe Kapitel 7)

\* Immundiagnostik AG empfiehlt die Verwendung von Reinstwasser nach ISO 3696. Es handelt sich dabei um Wasser des Typs 1, welches frei von ungelösten und kolloidalen Ionen und organischen Molekülen ist (frei von Partikeln > 0,2 µm) mit einer elektrischen Leitfähigkeit von 0,055 µS/cm bei 25 °C (≥ 18,2 MΩ cm).

## 5. LAGERUNG UND VORBEREITUNG DER REAGENZIEN

- Bitte achten Sie bei mehrfachem Einsatz des Kits darauf, dass die Reagenzien wie auf dem Etikett angegeben gelagert und **nur die für den jeweiligen Ansatz benötigten Reagenzienmengen frisch angesetzt werden**. Der Kit kann so bis zu 4x je nach Probenaufkommen bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendet werden.
- Reagenzien mit einem **Volumen kleiner 100 µl** sollten vor Gebrauch kurz anzentrifugiert werden, um Volumenverluste zu vermeiden.
- **Vorbereitung des Waschpuffers:** Das **Waschpufferkonzentrat (WASHBUF)** muss vor Gebrauch **1:5** in Reinstwasser verdünnt werden (200 ml WASHBUF + 800 ml Reinstwasser), gut mischen. Aufgrund des hohen Salzgehalts im Konzentrat kann es zu Kristallbildungen kommen. Die Kristalle lösen sich bei Raumtemperatur bzw. im Wasserbad bei 37 °C auf. Das **WASHBUF** kann bei **2–8 °C** bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum aufbewahrt werden. Der **Waschpuffer** (1:5 verdünntes WASHBUF) ist **1 Monat bei 2–8 °C** in einem geschlossenen Gefäß haltbar.

### **Achtung:**

**Dieser WASHBUF ist ausschließlich für den IDK® DAO-ELISA geeignet. Kristalle im WASHBUF vor der Verdünnung gründlich lösen.**

- **Die lyophilisierten Standards (STD) und Kontrollen (CTRL)** sind bei **2–8 °C** bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendbar. STD und CTRL werden mit **500 µl Probenverdünnungspuffer (SAMPLEBUF)** rekonstituiert und kurz geschwenkt, um eine vollständige Rekonstitution zu gewährleisten. Sie werden zum Lösen 10 Minuten stehen gelassen und anschließend gründlich gemischt. **Standards und Kontrollen** (rekonstituierte STD und CTRL) **sind nicht stabil und können nicht gelagert werden**.
- **Vorbereitung des Konjugats und Detektionsantikörpers:** Das **Konjugatkonzentrat (CONJ)** und das **Detektionsantikörperkonzentrat (AB)** werden unmittelbar vor Gebrauch **1:101** in **Verdünnungspuffer** verdünnt (100 µl CONJ + 10 ml ABBUF), (100 µl AB + 10 ml ABBUF). Das CONJ und das AB sind bei **2–8 °C** bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum stabil. **Konjugat** (1:101 verdünntes CONJ) und **Detektionsantikörper** (1:101 verdünntes AB) **sind nicht stabil und können nicht gelagert werden**.
- Alle anderen Testreagenzien sind gebrauchsfertig und, bei **2–8 °C** gelagert, bis zum angegebenen Verfallsdatum (siehe Etikett) verwendbar.

## 6. PROBENLAGERUNG UND -VORBEREITUNG

### *Probenlagerung und -stabilität*

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Lagerung bei Raumtemperatur (15–30 °C): | 4 Tage   |
| Lagerung bei 2–8 °C:                    | 9 Tage   |
| Lagerung bei -20 °C:                    | 6 Monate |

### *Probenvorbereitung*

Serumproben werden vor dem Einsatz im Test **1:5** verdünnt, z. B.:

**50 µl** Probe + **200 µl** Probenverdünnungspuffer (SAMPLEBUF), gut mischen.

**100 µl** der Verdünnung werden pro Vertiefung im Test eingesetzt.

## 7. TESTDURCHFÜHRUNG

### *Testprinzip*

Dieser ELISA dient zur quantitativen Bestimmung von DAO in Serum. Es werden polyklonale Antikörper, die gegen die rekombinante DAO generiert wurden, verwendet. Standards, Kontrollen und verdünnte Patientenproben, die auf DAO zu untersuchen sind, werden in die Vertiefungen einer Mikrotiterplatte pipettiert, welche mit einem polyklonalen Kaninchen-anti-DAO-Antikörper beschichtet sind. In diesem ersten Inkubationsschritt wird DAO aus der Probe vom Primärantikörper an die Mikrotiterplatte gebunden. Dann wird ein polyklonaler mit Biotin markierter anti-DAO-Antikörper zugegeben. Der nächste Schritt ist die Zugabe des Streptavidin-POD-Konjugats, es bildet sich folgender Komplex an der Wand der Mikrotiterplatte:

1. Antikörper – DAO-biotinylierter Antikörper – Streptavidin-POD-Konjugat

Als Peroxidasesubstrat wird Tetramethylbenzidin (TMB) eingesetzt. Die Enzymreaktion wird durch Zugabe von Säure abgestoppt. Dadurch erfolgt ein Farbumschlag von blau nach gelb. Die entstandene chromogene Verbindung wird photometrisch bei 450 nm gemessen. Die Intensität der Farbe ist dem DAO-Gehalt direkt proportional. Anhand einer mitgeführten Standardkurve – optische Dichte (Absorption bei 450 nm) versus Standardkonzentration – lässt sich die Konzentration der Probe ermitteln.

### *Pipettierschema*

Vor Gebrauch alle Reagenzien und Proben auf Raumtemperatur (15–30 °C) bringen, gut mischen.

Markieren Sie die Positionen für Standards/Kontrollen/Proben im Protokollblatt.

Die benötigten Mikrotiterstreifen aus dem Kit nehmen. Nicht verwendete Mikrotiterstreifen können in der gut verschlossenen Aluminiumverpackung bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum bei 2–8 °C gelagert werden.

Im Fall einer automatisierten Abarbeitung des Tests können automaten-spezifische Anpassungen der Prozedur notwendig sein, um den jeweiligen technischen Gegebenheiten gerecht zu werden. Für Unterstützung und Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter oder Immundiagnostik AG.

Wir empfehlen, die Bestimmungen in Doppelwerten durchzuführen.

|     |                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Die Vertiefungen <b>vor Gebrauch 5 x mit je 250 µl Waschpuffer</b> waschen. Nach dem letzten Waschschrift Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähigem Papier entfernen.         |
| 2.  | <b>100 µl Standards/Kontrollen/verdünnte Proben</b> in die jeweiligen Vertiefungen pipettieren.                                                                                            |
| 3.  | Streifen abdecken und <b>2 Stunden bei 37 °C unter Schütteln*</b> inkubieren.                                                                                                              |
| 4.  | Inhalt der Vertiefungen verwerfen und <b>5 x mit je 250 µl Waschpuffer</b> waschen. Nach dem letzten Waschschrift Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähigem Papier entfernen. |
| 5.  | <b>100 µl Detektionsantikörper</b> (verdünntes AB) in jede Vertiefung pipettieren.                                                                                                         |
| 6.  | Streifen abdecken und <b>1 Stunde bei 37 °C unter Schütteln*</b> inkubieren.                                                                                                               |
| 7.  | Inhalt der Vertiefungen verwerfen und <b>5 x mit je 250 µl Waschpuffer</b> waschen. Nach dem letzten Waschschrift Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähigem Papier entfernen. |
| 8.  | <b>100 µl Konjugat</b> (verdünntes CONJ) in jede Vertiefung pipettieren.                                                                                                                   |
| 9.  | Streifen abdecken und <b>1 Stunde bei 37 °C unter Schütteln*</b> inkubieren.                                                                                                               |
| 10. | Inhalt der Vertiefungen verwerfen und <b>5 x mit je 250 µl Waschpuffer</b> waschen. Nach dem letzten Waschschrift Reste von Waschpuffer durch Ausklopfen auf saugfähigem Papier entfernen. |
| 11. | <b>100 µl Substrat</b> (SUB) in jede Vertiefung pipettieren.                                                                                                                               |
| 12. | <b>10–20 min**</b> bei Raumtemperatur (15–30 °C) <b>im Dunkeln</b> inkubieren.                                                                                                             |
| 13. | <b>100 µl Stopplösung</b> (STOP) in jede Vertiefung pipettieren, gut mischen.                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | <b>Extinktion sofort</b> im Mikrotiterplattenphotometer bei <b>450 nm</b> gegen die Referenzwellenlänge 620 nm (oder 690 nm) messen. Ist keine Referenzwellenlänge vorhanden, wird nur bei 450 nm gemessen. Falls die Extinktion des höchsten Standards den Messbereich des Photometers übersteigt, sollte sofort bei <b>405 nm</b> gegen 620 nm (690 nm) gemessen werden. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Wir empfehlen die Streifen bei 700 rpm (Umdrehungen pro Minute) mit einem Orbit von 2 mm zu schütteln.

\*\* Die Intensität der Farbentwicklung ist temperaturabhängig. Es wird empfohlen, den Farbumschlag während der Inkubationszeit zu beobachten und entsprechend der Farbentwicklung die Reaktion zu stoppen.

## 8. ERGEBNISSE

Die unten beschriebenen mathematischen Modelle können alternativ zur Auswertung benutzt werden. Wir empfehlen die 4-Parameter-Funktion:

### 1. 4-Parameter-Funktion

Für die optische Dichte empfehlen wir eine lineare Ordinate und für die Konzentration eine logarithmische Abszisse (bei einer logarithmischen Abszisse muss für den Standard mit der Konzentration 0 ein Wert kleiner 1 eingegeben werden z.B. 0,001).

### 2. Punkt-zu-Punkt-Auswertung

Für die optische Dichte und für die Konzentration empfehlen wir eine lineare Ordinate bzw. Abszisse.

### 3. Gewichtete Spline-Funktion

Für die optische Dichte und für die Konzentration empfehlen wir eine lineare Ordinate bzw. Abszisse.

Vor jeder automatischen Auswertung sollte stets eine Kontrolle der Doppelwerte auf Plausibilität („Ausreißerkontrolle“) durchgeführt werden; falls dies nicht durch das verwendete Programm erfolgt, sollte die Kontrolle manuell durchgeführt werden.

### Proben

Die ermittelten Ergebnisse werden mit dem **Verdünnungsfaktor 5** multipliziert, um die tatsächlichen Konzentrationen zu erhalten.

Sollte ein **anderer Verdünnungsfaktor** verwendet worden sein, so ist die ermittelte Konzentration mit dem verwendeten Verdünnungsfaktor zu multiplizieren.

## 9. EINSCHRÄNKUNGEN

Proben mit Konzentrationen oberhalb des Messbereichs (Definition siehe unten) müssen stärker verdünnt und erneut gemessen werden. Bitte beachten Sie diese stärkere Verdünnung bei der Ergebnisberechnung.

Proben mit Konzentrationen unterhalb des Messbereichs (Definition siehe unten) können nicht klar quantifiziert werden.

Die Obergrenze des Messbereichs ergibt sich aus:

*höchste Konzentration der Standardkurve × anzuwendender Probenverdünnungsfaktor*

Die Untergrenze des Messbereichs ergibt sich aus:

*LoB × anzuwendender Probenverdünnungsfaktor*

LoB siehe Kapitel „Testcharakteristika“.

## 10. QUALITÄTSKONTROLLE

Immundiagnostik AG empfiehlt den Einsatz von externen Kontrollen für die interne Qualitätskontrolle, wenn möglich.

Wir empfehlen, bei jedem Testansatz Kontrollen mitzumessen. Die Ergebnisse der Kontrollen müssen auf Richtigkeit überprüft werden. Liegen eine oder mehrere Kontrollen außerhalb des angegebenen Bereiches, kann Immundiagnostik AG die Richtigkeit der Messergebnisse nicht gewährleisten.

### *Referenzbereiche*


|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| < 3 U/ml:  | HIT (Histaminintoleranz) anzunehmen |
| 3–10 U/ml: | HIT wahrscheinlich                  |
| > 10 U/ml: | HIT wenig wahrscheinlich            |

Umrechnungsfaktor: 1 U/ml = 1,25 ng/ml.

Wir empfehlen jedem Labor, einen eigenen Referenzbereich zu etablieren.

**Vergleich “Schwangere Frauen” und “Gesunde Kontrollen”**

Zur klinischen Evaluierung haben wir Proben von Schwangeren im Vergleich zu Proben von augenscheinlich Gesunden untersucht. Der IDK® DAO-ELISA zeigt, wie erforderlich und erwartet, bei Schwangeren höhere Werte im Vergleich zu Gesunden.

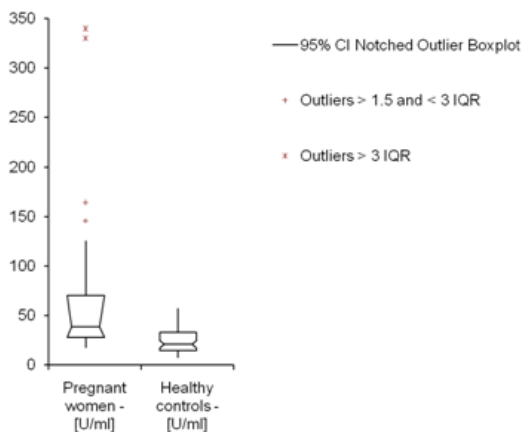

*Heparinbehandlung*

Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass die DAO-Konzentration nach Heparingabe ansteigt. Unsere Ergebnisse zeigen, dass nach der Gabe von Heparin bei gesunden Probanden die DAO-Konzentration innerhalb von 30 Minuten im Vergleich zum Basalwert stark angestiegen ist.

**Behandlungsergebnis vor und nach Heparingabe**

IDK® DAO-ELISA [U/ml]

|           | VOR Gabe | 30 min NACH | 60 min NACH |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| Patient 1 | 76       | 219         | -           |
| Patient 2 | 55       | 152         | -           |
| Patient 3 | 2,5      | 277         | 622         |
| Patient 4 | 18,9     | 621         | 555         |

Der IDK® DAO-ELISA bestimmt die Konzentration des Enzyms, wohingegen die herkömmlichen Histaminintoleranztests mit Putrescin oder Histamin als Substrate die DAO-Aktivität bestimmen. Daher ist es nicht zwangsläufig eine Korrelation mit einem Koeffizienten  $r > 0,8$  zu erwarten. Dies vor dem Hintergrund, dass die Aktivität nicht nur von der Anzahl der Moleküle abhängt, sondern Kofaktoren wie Vitamin C,

Vitamin B6, Kupfer und Manganionen für die DAO Aktivität *in vitro* und *in vivo* mitentscheidend sind. Daher empfehlen wir bei der Histaminintoleranz-Diagnostik, wenn sie denn über Aktivitätstests bestimmt wird, zur Verifizierung der Ursache neben der DAO-Aktivität auch die genannten Kofaktoren mitzubestimmen. Die Ursache liegt möglicherweise nicht in einer verminderten DAO-Konzentration, sondern an einer Mangelsituation der Kofaktoren.

Die Histaminintoleranzsymptomatik kann durch DAO-Aktivitätsmangel hervorgerufen werden, weil die oben beschriebenen Kofaktoren in nicht ausreichender Menge vorliegen. Durch die Bestimmung der Kofaktoren kann ermittelt werden, welcher der Faktoren supplementiert werden sollte.

### Medikamentenwirkung

Bei weiterem Auftreten der Histaminintoleranz-Erscheinungen können Medikamente den DAO-Aktivitätsmangel verursachen. Beispiele hierfür sind:

(aus Maintz u. Novak 2007)

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Muskelrelaxantien                      | Pancuronium, Alcuronium, D-Tubocurarine                                              |
| Narkosemittel                          | Thiopental                                                                           |
| Analgetika                             | Morphin, Pethidin, nichtsteroidale<br>Antiphlogistika, Acetylsalicylsäure, Metamizol |
| Lokalanästhetika                       | Prilocain                                                                            |
| Antihypotonika                         | Dobutamin                                                                            |
| Blutdrucksenkende Mittel               | Verapamil, Alprenolol, Dihydralazin                                                  |
| Antiarrhythmika                        | Propafenon                                                                           |
| Diuretika                              | Amilorid                                                                             |
| Darmmotilität<br>beeinflussende Mittel | Metoclopramid                                                                        |
| Antibiotika                            | Cefuroxim, Cefotiam, Isoniazid, Pentamidin,<br>Clavulansäure, Choroquin              |
| Mukolytika                             | Acetylcystein, Ambroxol                                                              |
| Broncholytika                          | Aminophyllin                                                                         |
| H2-Rezeptor-Antagonisten               | Cimetidin                                                                            |
| Zytostatika                            | Cyclophosphamid                                                                      |
| Antidepressiva                         | Amitriptylin                                                                         |

Bei der Einnahme solcher Medikamente sollte der Arzt kontaktiert werden, ob nicht alternative Medikamente empfohlen werden können und möglicherweise damit die Histaminintoleranz-Symptomatik behoben werden kann.

## 11. TESTCHARAKTERISTIKA

### *Präzision und Reproduzierbarkeit*

Die Reproduzierbarkeit von zwei Proben innerhalb einer Messserie wurde geprüft. Zwei Normalproben wurden 16-mal in einem IDK® DAO-ELISA von einer Person angesetzt.

#### **Intra-Assay (n= 16)**

| Probe | DAO [U/ml] | VK [%] |
|-------|------------|--------|
| 1     | 5,0        | 1,42   |
| 2     | 5,9        | 1,72   |

Die Reproduzierbarkeit von zwei Proben wurde geprüft. Zwei Normalproben wurden 8-mal an drei verschiedenen Tagen von verschiedenen Personen im IDK® DAO-ELISA gemessen.

#### **Inter-Assay (n= 8)**

| Probe | DAO [U/ml] | VK [%] |
|-------|------------|--------|
| 1     | 23,27      | 7,9    |
| 2     | 13,36      | 10,7   |

### *Wiederfindung in der Verdünnung*

Zwei Proben unterschiedlicher Konzentrationen wurden auf Verdünnungsgerechtigkeit überprüft. (n = 2)

| Probe | Verdünnung | Erwartet [U/ml] | Gemessen [U/ml] |
|-------|------------|-----------------|-----------------|
| A     | 1:5        | 15,65           | 15,65           |
|       | 1:10       | 7,83            | 7,68            |
|       | 1:20       | 3,92            | 3,86            |
|       | 1:40       | 1,96            | 1,86            |
| B     | 1:5        | 5,58            | 5,58            |
|       | 1:10       | 2,79            | 2,89            |
|       | 1:20       | 1,39            | 1,45            |
|       | 1:40       | 0,7             | 0,7             |

### *Analytische Sensitivität*

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Leerwert ( <i>limit of blank</i> , LoB)                 | 0,079 U/ml |
| Nachweisgrenze ( <i>limit of detection</i> , LoD)       | 0,120 U/ml |
| Bestimmungsgrenze ( <i>limit of quantitation</i> , LoQ) | 0,120 U/ml |

Die Auswertung wurde gemäß der CLSI-Richtlinie EP-17-A2 durchgeführt. Das festgelegte Präzisionsziel für die Bestimmungsgrenze lag bei 20 % VK.

## 12. VORSICHTSMASSNAHMEN

- Alle im Kit enthaltenen Reagenzien dürfen ausschließlich zur *in-vitro*-Diagnostik verwendet werden.
- Das für Kitkomponenten verwendete humane Material wurde auf HIV, Hepatitis B und Hepatitis C getestet und für negativ befunden. Dennoch wird empfohlen, die Kitkomponenten als Vorsichtsmaßnahme immer wie potentiell infektiöses Material zu behandeln.
- Die Kitkomponenten enthalten zum Schutz vor bakteriellen Kontaminationen Natriumazid oder ProClin. Natriumazid bzw. ProClin sind giftig. Auch Substrate für enzymatische Farbreaktionen sind als giftig und karzinogen beschrieben. Jeder Kontakt mit Haut oder Schleimhaut ist zu vermeiden.
- Die Stopplösung besteht aus verdünnter Schwefelsäure ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ).  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ist eine starke Säure und muss auch in verdünnter Form mit Vorsicht benutzt werden.  $\text{H}_2\text{SO}_4$  verursacht bei Kontakt mit der Haut Verätzungen. Es sollte daher mit Schutzhandschuhen, Schutzkleidung und Schutzbrille gearbeitet werden. Bei Kontakt mit der Säure muss die verätzte Stelle sofort mit viel Wasser gespült werden. Dämpfe nicht einatmen und Inhalation vermeiden.

## 13. TECHNISCHE MERKMALE

- Reagenzien der Testpackung dürfen nicht mit anderen Chargen gemischt werden. Ferner dürfen Kavitäten unterschiedlicher Mikrotiterplatten, selbst der gleichen Charge, nicht zusammengefügt und zur Analyse verwendet werden.
- Qualitätskontrollen sollten immer mitgemessen werden.
- Die Reagenzien dürfen nach Ablauf des auf der Kitverpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwendet werden.
- Substratlösung muss vor Gebrauch farblos sein.

- Mikrotiterstreifen müssen während der Inkubationen mit Folie abgedeckt sein.
- Vermeiden Sie Schaumbildung beim Mischen der Reagenzien.
- Stopfen und Verschlüsse verschiedener Reagenzien dürfen nicht vertauscht werden.
- Der Assay ist immer nach der dem Kit beigelegten Arbeitsanleitung durchzuführen.

## 14. ALLGEMEINE HINWEISE ZUM TEST

- Dieser Kit wurde nach der IVD-Richtlinie 98/79/EG hergestellt und in den Verkehr gebracht.
- Für die Qualitätskontrolle sind die für medizinische Laboratorien erstellten Richtlinien zu beachten.
- IDK® ist eine Marke der Immundiagnostik AG.
- Die Testcharakteristika wie Inkubationszeiten, Inkubationstemperaturen und Pipettiervolumina der verschiedenen Komponenten wurden vom Hersteller festgelegt. Nicht mit dem Hersteller abgesprochene Veränderungen in der Testdurchführung können die Resultate beeinflussen. Die Firma Immundiagnostik AG übernimmt für die hierdurch entstandenen Schäden und Folgeschäden keine Haftung.
- Bei Gewährleistungsansprüchen ist das beanstandete Material mit schriftlicher Erklärung innerhalb von 14 Tagen zum Hersteller, der Immundiagnostik AG, zurückzusenden.

## 15. LITERATUR

1. Sattler J et al. (1988) Food induced histaminosis as an epidemiological problem: plasma histamine elevation and haemodynamic alterations after oral histamine administration and blockade of diamine oxidase (DAO). *Agents and Actions* **23**:361-65.
2. Tufvesson G et al. (1969) Determination of DAO-activity in normal human blood serum. *Scand J Clin Lab Invest* **24**:163-68.
3. Wantke F et al. (1999) The red wine maximization test: drinking histamine rich wine induces a transient increase of plasma diamine oxidase activity in healthy volunteers. *Inflammation Research* **48**:169-70.

4. Wantke F et al. (1994) The red wine provocation test: intolerance to histamine as a model für food intolerance. *Allergy Proceedings* **15**:27-32.
5. Wantke F et al. (1998) Daily variations of serum diamine oxidase and the influence of H1 and H2 blockers: a critical approach to routine diamine oxidase assessment. *Inflammation Research* **47**:396-400.
6. Jarisch R et al. (1999) Role of food allergy and food intolerance in recurrent urticaria. In: Wüthrich B (Hrsg): The Atopy Syndrome in the Third Millennium. *Curr Probl Dermatol*, Basel, Karger, **28**:64-73.
7. Wantke F et al. (1993) Histamine free diet: treatment of choice for histamine induced food intolerance and supporting treatment for chronic headaches *Clin Exp Allergy* **23**: 982-85.
8. Götz M et al. (1996) Histamin-Intoleranz und Diaminoxidasemangel *Allergologie* **9**: 426-30.
9. Jarisch Reinhart, Histamin-Intoleranz. **1. Auflage** (1999), *Thieme-Verlag*, Stuttgart

### Verwendete Symbole:



Temperaturbegrenzung



Bestellnummer



In-Vitro-Diagnostikum



Zu verwenden mit



Hersteller



Inhalt ausreichend für &lt;n&gt; Prüfungen



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis



Achtung



Gebrauchsanweisung beachten


**Manual**

# **IDK<sup>®</sup> DAO ELISA**

***For the in vitro determination of DAO in serum***

Valid from 2018-03-22

**REF** **K 8500**



**IVD**



**Immundiagnostik AG**, Stubenwald-Allee 8a, 64625 Bensheim, Germany

Tel.: +49 6251 70190-0

Fax: + 49 6251 849430

e.mail: [info@immundiagnostik.com](mailto:info@immundiagnostik.com) [www.immundiagnostik.com](http://www.immundiagnostik.com)

# Table of Contents

1. INTENDED USE \_\_\_\_\_ 17

2. INTRODUCTION \_\_\_\_\_ 17

3. MATERIAL SUPPLIED \_\_\_\_\_ 18

4. MATERIAL REQUIRED BUT NOT SUPPLIED \_\_\_\_\_ 18

5. STORAGE AND PREPARATION OF REAGENTS \_\_\_\_\_ 19

6. STORAGE AND PREPARATION OF SAMPLES \_\_\_\_\_ 20

*Sample storage* \_\_\_\_\_ 20

*Sample preparation* \_\_\_\_\_ 20

7. ASSAY PROCEDURE \_\_\_\_\_ 20

*Principle of the test* \_\_\_\_\_ 20

*Test procedure* \_\_\_\_\_ 20

8. RESULTS \_\_\_\_\_ 22

9. LIMITATIONS \_\_\_\_\_ 23

10. QUALITY CONTROL \_\_\_\_\_ 23

*Reference range* \_\_\_\_\_ 23

*Heparin treatment* \_\_\_\_\_ 24

11. PERFORMANCE CHARACTERISTICS \_\_\_\_\_ 26

*Precision and reproducibility* \_\_\_\_\_ 26

*Sample dilution* \_\_\_\_\_ 26

*Analytical Sensitivity* \_\_\_\_\_ 27

12. PRECAUTIONS \_\_\_\_\_ 27

13. TECHNICAL HINTS \_\_\_\_\_ 27

14. GENERAL NOTES ON THE TEST AND TEST PROCEDURE \_\_\_\_\_ 28

15. REFERENCES \_\_\_\_\_ 28

## 1. INTENDED USE

This Immundiagnostik AG assay is an enzyme immunoassay intended for the quantitative determination of diamine oxidase (DAO) in serum. For *in vitro* diagnostic use only

## 2. INTRODUCTION

Diamine oxidase (DAO) is a body's own enzyme that metabolises histamine. Although DAO is found practically in the whole body, the most important site of its action is the intestine. The enzymatic activity of DAO determines the histamine degradation speed. In the case of DAO deficiency or inhibition, incorporated or endogenous histamine cannot be degraded quickly enough, and the symptoms of histamine intolerance are presented. Millions of people suffer from gastrointestinal problems, migraine, irritations of nasal mucosa and other allergy-like symptoms after consumption of certain nutrients. Too much histamine in the body can be the reason for this wide range of symptoms.

The determination of DAO serum concentration (K 8500) combined with the determination of DAO activity (K 8220 DAO REA) is a suitable marker for the differential diagnosis of histamine intolerance and associated symptoms.

Our IDK® DAO ELISA kit is intended for determination of the diamine oxidase (DAO) concentration in serum.

### Indications

- Frequent headaches or migraine
- Snuffles after consumption of histamine-containing nutrients
- Tissue oedema
- Eyelid turgor
- Skin redness
- Limb aches
- Gastrointestinal discomfort
- Monitoring of a histamine free diet

### 3. MATERIAL SUPPLIED

| Cat. No | Label     | Kit Components                                                   | Quantity     |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| K 8500  | PLATE     | Microtiter plate, pre-coated                                     | 12 x 8 wells |
| K 8500  | WASHBUF   | Wash buffer concentrate, 5 x                                     | 4 x 100 ml   |
| K 8500  | STD       | Standards, lyophilised<br>(see specification for concentrations) | 4 x 5 vials  |
| K 8500  | CTRL1     | Control, lyophilised<br>(see specification for range)            | 4 x 1 vial   |
| K 8500  | CTRL2     | Control, lyophilised<br>(see specification for range)            | 4 x 1 vial   |
| K 8500  | AB        | Detection antibody concentrate ,<br>biotinylated                 | 1 x 200 µl   |
| K 8500  | CONJ      | Conjugate concentrate,<br>peroxidase-labelled (streptavidin)     | 1 x 200 µl   |
| K 8500  | ABBUF     | Dilution buffer for AB and CONJ,<br>ready-to-use                 | 1 x 50 ml    |
| K 8500  | SAMPLEBUF | Sample dilution buffer, ready-to-use                             | 1 x 50 ml    |
| K 8500  | SUB       | Substrate (tetramethylbenzidine),<br>ready-to-use                | 1 x 15 ml    |
| K 8500  | STOP      | Stop solution, ready-to-use                                      | 1 x 15 ml    |

For reorders of single components, use the catalogue number followed by the label as product number.

### 4. MATERIAL REQUIRED BUT NOT SUPPLIED

- Standard laboratory reaction vessels (1.5 ml)
- Standard laboratory reaction vessel (15 ml)
- Foil to cover the microtiter plate
- Vortex mixer
- Ultra pure water\*
- Microtiter plate thermoshaker at 37 °C (for example model Shake ID2 available at Immundiagnostik AG)
- Microtiter plate reader (required filters see chapter 7)

\* Immundiagnostik AG recommends the use of Ultra Pure Water (Water Type 1; ISO 3696), which is free of undissolved and colloidal ions and organic molecules (free of particles > 0.2 µm) with an electrical conductivity of 0.055 µS/cm at 25 °C (≥ 18.2 MΩ cm).

## 5. STORAGE AND PREPARATION OF REAGENTS

- To run the assay more than once, ensure that reagents are stored at the conditions stated on the label. **Prepare only the appropriate amount necessary for each run.** The kit can be used up to 4 times within the expiry date stated on the label.
- Reagents with a volume less than **100 µl** should be centrifuged before use to avoid loss of volume.
- **Preparation of the wash buffer:** The **wash buffer concentrate (WASHBUF)** has to be diluted with ultra pure water **1:5** before use (200 ml WASHBUF + 800 ml ultra pure water), mix well. Crystals could occur due to high salt concentration in the concentrate. Before dilution, the crystals have to be redissolved at room temperature or in a water bath at 37 °C. The **WASHBUF** is stable at **2–8 °C** until the expiry date stated on the label. **Wash buffer** (1:5 diluted WASHBUF) can be stored in a closed flask at **2–8 °C for 1 month**.

**Please note:**

**This WASHBUF is intended only for use in the IDK® DAO ELISA. Crystals in the WASHBUF must be completely dissolved before dilution.**

- The **lyophilised standards (STD)** and **controls (CTRL)** are stable at **2–8 °C** until the expiry date stated on the label. Before use, the STD and CTRL have to be reconstituted with **500 µl sample dilution buffer (SAMPLEBUF)** and mixed by gentle inversion to ensure complete reconstitution. Allow the vial content to dissolve for 10 minutes and then mix thoroughly. **Standards and controls** (reconstituted STD and CTRL) **are not stable and cannot be stored**.
- **Preparation of the conjugate and the detection antibody:** Before use, the **conjugate concentrate (CONJ)** and the **detection antibody concentrate (AB)** have to be diluted **1:101** in **dilution buffer** (100 µl CONJ + 10 ml ABBUF), (100 µl AB + 10 ml ABBUF). The CONJ and the AB are stable at **2–8 °C** until the expiry date stated on the label. **Conjugate** (1:101 diluted CONJ) and **detection antibody** (1:101 diluted AB) **are not stable and cannot be stored**.
- All other test reagents are ready-to-use. Test reagents are stable until the expiry date (see label) when stored at **2–8 °C**.

## 6. STORAGE AND PREPARATION OF SAMPLES

### *Sample storage*

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Storage at room temperature (15–30 °C): | 4 days   |
| Storage at 2–8 °C:                      | 9 days   |
| Storage at -20 °C:                      | 6 months |

### *Sample preparation*

Serum samples must be diluted **1:5** before performing the assay,  
e.g. **50 µl** sample + **200 µl** sample dilution buffer (SAMPLEBUF), mix well.  
**100 µl** of the dilution are used in the test.

## 7. ASSAY PROCEDURE

### *Principle of the test*

This ELISA is designed for the quantitative determination of DAO in serum. The assay utilises the sandwich technique with two polyclonal antibodies against recombinant DAO.

Standards, controls and diluted samples which are assayed for DAO are added into the wells of a micro plate coated with polyclonal rabbit anti-DAO antibody. During the first incubation step, DAO is bound by the immobilised primary antibody. Then a biotinylated polyclonal anti-DAO antibody is added into each microtiter well. In the next step, the streptavidin peroxidase conjugate is added and a “sandwich” of 1st antibody – DAO – biotinylated antibody – streptavidin peroxidase conjugate is formed. Tetramethylbenzidine (TMB) is used as peroxidase substrate. Finally, an acidic stop solution is added to terminate the reaction. The colour changes from blue to yellow. The intensity of the yellow colour is directly proportional to the concentration of DAO. A dose response curve of the absorbance unit (optical density, OD at 450 nm) vs. concentration is generated, using the values obtained from the standard. DAO, present in the patient samples, is determined directly from this curve.

### *Test procedure*

Bring all **reagents and samples to room temperature** (15–30 °C) and mix well.  
Mark the positions of standards/controls/samples on a protocol sheet.

Take as many microtiter strips as needed from kit. Store unused strips in the carefully closed aluminium packaging at 2–8° C. Strips are stable until expiry date stated on the label.

For automated ELISA processors, the given protocol may need to be adjusted according to the specific features of the respective automated platform. For further details please contact your supplier or Immundiagnostik AG.

We recommend to carry out the tests in duplicate.

|     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Before use</b> , wash the wells <b>5 times</b> with <b>250 µl wash buffer</b> . After the final washing step, remove residual wash buffer by firmly tapping the plate on absorbent paper.        |
| 2.  | Add each <b>100 µl standards/controls/diluted samples</b> into the respective wells.                                                                                                                |
| 3.  | Cover the strips and incubate for <b>2 hours</b> at <b>37 °C</b> on a <b>horizontal shaker*</b> .                                                                                                   |
| 4.  | Discard the content of each well and wash <b>5 times</b> with <b>250 µl wash buffer</b> . After the final washing step, remove residual wash buffer by firmly tapping the plate on absorbent paper. |
| 5.  | Add <b>100 µl detection antibody</b> (diluted AB) into each well, mix gently.                                                                                                                       |
| 6.  | Cover the strips and incubate for <b>1 hour</b> at <b>37 °C</b> on a <b>horizontal shaker*</b> .                                                                                                    |
| 7.  | Discard the contents of each well and wash <b>5 times</b> with <b>250 µl wash buffer</b> . After the final washing step, the inverted microtiter plate should be firmly tapped on absorbent paper.  |
| 8.  | Add <b>100 µl conjugate</b> (diluted CONJ) into each well.                                                                                                                                          |
| 9.  | Cover the strips and incubate for <b>1 hour</b> at <b>37 °C</b> on a <b>horizontal shaker*..</b>                                                                                                    |
| 10. | Discard the contents of each well and wash <b>5 times</b> with <b>250 µl wash buffer</b> . After the final washing step, the inverted microtiter plate should be firmly tapped on absorbent paper.  |
| 11. | Add <b>100 µl substrate</b> (SUB) into each well.                                                                                                                                                   |
| 12. | Incubate for <b>10–20 min**</b> at room temperature (15–30 °C) in the <b>dark</b> .                                                                                                                 |
| 13. | Add <b>100 µl stop solution</b> (STOP) into each well and mix well.                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Determine <b>absorption immediately</b> with an ELISA reader at <b>450 nm</b> against 620 nm (or 690 nm) as a reference. If no reference wavelength is available, read only at 450 nm. If the extinction of the highest standard exceeds the range of the photometer, absorption must be measured immediately at <b>405 nm</b> against 620 nm as a reference. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* We recommend shaking the strips at 700 rpm with an orbit of 2 mm.

\*\* The intensity of the colour change is temperature sensitive. We recommend observing the colour change and stopping the reaction upon good differentiation.

8. RESULTS

The following algorithms can be used alternatively to calculate the results. We recommend using the “4 parameter algorithm”.

1. 4 parameter algorithm

It is recommended to use a linear ordinate for the optical density and a logarithmic abscissa for the concentration. When using a logarithmic abscissa, the zero standard must be specified with a value less than 1 (e.g. 0.001).

2. Point-to-point calculation

We recommend a linear ordinate for the optical density and a linear abscissa for the concentration.

3. Spline algorithm

We recommend a linear ordinate for the optical density and a linear abscissa for the concentration.

The plausibility of the duplicate values should be examined before the automatic evaluation of the results. If this option is not available with the programme used, the duplicate values should be evaluated manually.

Samples

The obtained results have to be multiplied by the **dilution factor of 5** to get the actual concentrations.

In case **another dilution factor** has been used, multiply the obtained result by the dilution factor used.

## 9. LIMITATIONS

Samples with concentrations above the measurement range (see definition below) must be further diluted and re-assayed. Please consider this greater dilution when calculating the results.

Samples with concentrations lower than the measurement range (see definition below) cannot be clearly quantified.

The upper limit of the measurement range can be calculated as:

*highest concentration of the standard curve × sample dilution factor to be used*

The lower limit of the measurement range can be calculated as:

*LoB × sample dilution factor to be used*

LoB see chapter "Performance Characteristics".

## 10. QUALITY CONTROL

Immundiagnostik AG recommends the use of external controls for internal quality control, if possible.

Control samples should be analysed with each run. Results, generated from the analysis of control samples, should be evaluated for acceptability using appropriate statistical methods. The results for the patient samples may not be valid if within the same assay one or more values of the quality control sample are outside the acceptable limits.

### *Reference range*


|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| < 3 U/ml:    | high incidence for HIT (Histamine intolerance) |
| 3 - 10 U/ml: | HIT probable                                   |
| > 10 U/ml:   | low incidence for HIT                          |

Conversion factor: 1 U/ml = 1.25 ng/ml

We recommend each laboratory to establish its own reference range.

### Comparison “Pregnant women” and “Healthy controls”

For the clinical evaluation of this assay we have analysed samples from pregnant women and apparently healthy controls. The IDK® DAO ELISA detects, as required and expected, higher values in pregnant women than in healthy controls.

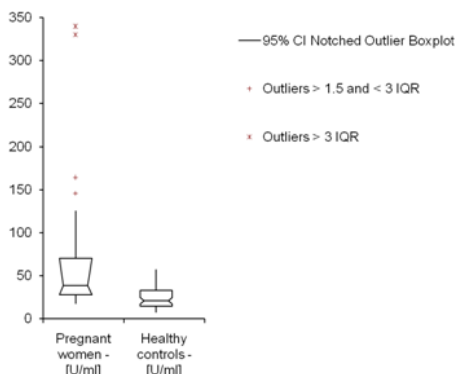

### Heparin treatment

Furthermore, DAO levels in healthy study participants increased sharply within 30 minutes of heparin administration. It has been documented in scientific literature that DAO levels rise after heparin administration.

### Treatment outcome before and after heparin administration

IDK® DAO ELISA [U/ml]

|           | BEFORE administration | 30 min AFTER | 60 min AFTER |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| Patient 1 | 76                    | 219          | -            |
| Patient 2 | 55                    | 152          | -            |
| Patient 3 | 2.5                   | 277          | 622          |
| Patient 4 | 18.9                  | 621          | 555          |

Since the IDK® DAO ELISA determines DAO concentration while the conventional histamine intolerance tests with putrescine or histamine as substrates determine DAO activity, the correlation coefficient must not necessarily be  $r > 0.8$ . This can be explained by the fact that the activity does not depend on the number of molecules alone, but also on cofactors such as vitamin C, vitamin B6, copper or manganese ions in vitro and in vivo. For the diagnosis of histamine intolerance via DAO activity test we therefore recommend to determine the above mentioned cofactors as well. The problem may not be a low DAO level, but a cofactor deficiency.

The symptoms of histamine intolerance can be caused by low DAO activity because the above-mentioned cofactors are not sufficiently available. By quantitating the cofactors it can be determined which one needs to be supplemented.

### Medication effects

In addition, histamine intolerance symptoms may be due to low DAO activity caused by medication such as:

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muscle relaxants               | Pancuronium, alcuronium, D-tubocurarine                                                     |
| Narcotics                      | Thiopental                                                                                  |
| Analgetics                     | Morphine, pethidine, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, acetylsalicylic acid, metamizole |
| Local anesthetics              | Prilocaine                                                                                  |
| Antihypotonics                 | Dobutamine                                                                                  |
| Antihypertensive drugs         | Verapamil, alprenolol, dihydralazine                                                        |
| Antiarrhythmics                | Propafenone                                                                                 |
| Diuretics                      | Amiloride                                                                                   |
| Drugs influencing gut motility | Metoclopramide                                                                              |
| Antibiotics                    | Cefuroxime, cefotiam, isoniazid, pentamidin, clavulanic acid, chloroquine                   |
| Mucolytics                     | Acetylcysteine, ambroxol                                                                    |
| Broncholytics                  | Aminophylline                                                                               |
| H2-receptor antagonists        | Cimetidine                                                                                  |
| Cytostatics                    | Cyclophosphamide                                                                            |
| Antidepressants                | Amitriptyline                                                                               |

If you are taking such medication, you may want to discuss with your physician alternative medication in order to relieve your symptoms.

## 11. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

### *Precision and reproducibility*

#### **Intra-Assay (n = 16)**

The precision (intra-assay variation) was calculated from 16 replicate determinations on each of two samples.

| Sample | DAO [U/ml] | CV [%] |
|--------|------------|--------|
| 1      | 5.0        | 1.42   |
| 2      | 5.9        | 1.72   |

#### **Inter-Assay (n = 8)**

The total precision (inter-assay variation) was calculated from data on 2 samples obtained in 8 different assays by different technicians on three different days.

| Probe | DAO [U/ml] | CV [%] |
|-------|------------|--------|
| 1     | 23.27      | 7.9    |
| 2     | 13.36      | 10.7   |

### *Sample dilution*

Two patient samples were diluted and assayed. The results are shown below:

Linearity n= 2

| Sample | Dilution | Expected [U/ml] | Measured [U/ml] |
|--------|----------|-----------------|-----------------|
| A      | 1:5      | 15.65           | 15.65           |
|        | 1:10     | 7.83            | 7.68            |
|        | 1:20     | 3.92            | 3.86            |
|        | 1:40     | 1.96            | 1.86            |
| B      | 1:5      | 5.58            | 5.58            |
|        | 1:10     | 2.79            | 2.89            |
|        | 1:20     | 1.39            | 1.45            |
|        | 1:40     | 0.7             | 0.7             |

### *Analytical Sensitivity*

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Limit of blank, LoB        | 0.079 U/ml |
| Limit of detection, LoD    | 0.120 U/ml |
| Limit of quantitation, LoQ | 0.120 U/ml |

The evaluation was performed according to the CLSI guideline EP-17-A2. The specified accuracy goal for the LoQ was 20 % CV.

## 12. PRECAUTIONS

- All reagents in the kit package are for *in vitro* diagnostic use only.
- Human materials used in kit components were tested and found to be negative for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C. However, for safety reasons, all kit components should be treated as potentially infectious.
- Kit reagents contain sodium azide or Proclin as bactericides. Sodium azide and Proclin are toxic. Substrates for the enzymatic colour reactions are toxic and carcinogenic. Avoid contact with skin or mucous membranes.
- The stop solution consists of diluted sulphuric acid, a strong acid. Although diluted, it still must be handled with care. It can cause burns and should be handled with gloves, eye protection, and appropriate protective clothing. Any spill should be wiped up immediately with copious quantities of water. Do not breath vapour and avoid inhalation.

## 13. TECHNICAL HINTS

- Do not interchange different lot numbers of any kit component within the same assay. Furthermore we recommend not assembling wells of different microtiter plates for analysis, even if they are of the same batch.
- Control samples should be analysed with each run.
- Reagents should not be used beyond the expiration date stated on kit label.
- Substrate solution should remain colourless until use.
- To ensure accurate results, proper adhesion of plate sealers during incubation steps is necessary.
- Avoid foaming when mixing reagents.
- Do not mix plugs and caps from different reagents.
- The assay should always be performed according to the enclosed manual.

## 14. GENERAL NOTES ON THE TEST AND TEST PROCEDURE

- This assay was produced and distributed according to the IVD guidelines of 98/79/EC.
- The guidelines for medical laboratories should be followed.
- IDK® is a trademark of Immundiagnostik AG.
- Incubation time, incubation temperature and pipetting volumes of the components are defined by the producer. Any variation of the test procedure, which is not coordinated with the producer, may influence the results of the test. Immundiagnostik AG can therefore not be held responsible for any damage resulting from incorrect use.
- Warranty claims and complaints regarding deficiencies must be logged within 14 days after receipt of the product. The product should be sent to Immundiagnostik AG along with a written complaint.

## 15. REFERENCES

1. Sattler J et al. (1988) Food induced histaminosis as an epidemiological problem: plasma histamine elevation and haemodynamic alterations after oral histamine administration and blockade of diamine oxidase (DAO). *Agents and Actions* **23**:361-65.
2. Tufvesson G et al. (1969) Determination of DAO-activity in normal human blood serum. *Scand J Clin Lab Invest* **24**:163-68.
3. Wantke F et al. (1999) The red wine maximization test: drinking histamine rich wine induces a transient increase of plasma diamine oxidase activity in healthy volunteers. *Inflammation Research* **48**:169-70.
4. Wantke F et al. (1994) The red wine provocation test: intolerance to histamine as a model for food intolerance. *Allergy Proceedings* **15**:27-32.
5. Wantke F et al. (1998) Daily variations of serum diamine oxidase and the influence of H1 and H2 blockers: a critical approach to routine diamine oxidase assessment. *Inflammation Research* **47**:396-400.
6. Jarisch R et al. (1999) Role of food allergy and food intolerance in recurrent urticaria. In: Wüthrich B (Hrsg): *The Atopy Syndrome in the Third Millennium. Curr Probl Dermatol*, Basel, Karger, **28**:64-73.

7. Wantke F et al. (1993) Histamine free diet: treatment of choice for histamine induced food intolerance and supporting treatment for chronic headaches *Clin Exp Allergy* **23**: 982-85.

8. Götz M et al. (1996) Histamin-Intoleranz und Diaminoxidasemangel *Allergologie* **9**: 426-30.

9. Jarisch Reinhart, Histamin-Intoleranz. **1. Auflage** (1999), *Thieme-Verlag*, Stuttgart

**Used symbols:**



Temperature limitation



Catalogue Number



In Vitro Diagnostic Medical Device



To be used with



Manufacturer



Contains sufficient for <n> tests



Lot number



Use by



Attention



Consult instructions for use